

## EGYSE felírás az Ixnet rendszerben

Az 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2021.11.01 után hatályos állapota szerint a segédeszköz felírásokat az EESZT-be kell küldeni mindenkinek, az eRecept mintájára mint eGYSE. Ebben a leírásban bemutatjuk az új felírás módjait, példákkal szemléltetve a különböző fajta felírásokat.


Segédeszköz felírásakor két új dolog jelenik meg, a Gyse gomb, ahol a segédeszköz felírás egyéb adatait kell megadnunk :

És egy új lenyíló menü, ahol az eGYSE felírás típusát kell bizonyos esetekben kézzel megadni:

**Az alábbi esetekben a TÉR nem fogja tudni befogadni a felírásokat:**


1. Amennyiben a páciens vagy a szervezet címe és telefonszáma nincs kitöltve:

Kérdés

 **A paciens címe nincs kitöltve! GYSE beküldéshez megadása kötelező!**  
**Ha nincs megadva, akkor a receptet a TÉR nem fogja befogadni(nem lesz e-Recept).**  
**Módosítja?**

Igen (ENTER)  Nem (ESC)


Kérdés

 **A szervezet címe/telefonszáma nincs kitöltve! GYSE beküldéshez megadása kötelező!**  
**Ha nincs megadva, akkor a receptet a TÉR nem fogja befogadni(nem lesz e-Recept).**  
**Módosítja?**

Igen (ENTER)  Nem (ESC)

2. Azon segédeszközök esetén melyhez szakorvosi javaslat tartozik ki kell tölteni a szakorvos nevét, pecsétszámát és a javaslat naplósámát:

Kérdés az EESZT előírása alapján

 **Ideál Teszt 50db/doboz**  
**A szakorvosi javaslaton nincs kitöltve a szakorvos neve és a naplósám, így a receptet a TÉR nem fogja befogadni(nem lesz e-Recept)!**

**Kitölti most?**

Igen (ENTER)  Nem (ESC)


**Felírási esetek:**

1. GYSE egy termék (általános segédeszköz felírás): Segédeszköz kiválasztása után, az alap adatokat kell megadni (BNO, adagolás), majd a Gyse ablakon ki kell tölteni a készítménynek megfelelő adatokat (oldaliség, testtáj, nyilatkozat, stb)

2. GYSE több termék (pl. Inzulin pumpa és infúziós szerelék): Az egy termékes felíráshoz hasonlóan felírunk 2 vagy több segédeszközt, majd a CTRL billentyű lenyomásával a készítmények neveire kattintva a Felírandó receptek részénél, tudjuk egy csoportba rakni őket. Ami ugyanolyan színű az tartozik egy csoportba. Ilyenkor ezeket a készítményeket egy felírásként küldi be a térbe, nem külön-külön. A készítményeket csak azonos jogcímen lehet felírni.

Név	Drb.	Egység	Jogcím	Adagolás	R1	R2	R3	Kiváltható	Ellátva	Diagn...	B	Akt.g...	Th.la...	N...	T...	OK	T...
Accu-Chek Combo inzulinpumpa rendszer	1	darab	1...	napl 3x1				2021.09.22		E1620	000						
AC Rapid-D Link infúziós szerelék (20x)	3	doboz	1...	napl 3x1				2021.09.22		E1620	000						

Több termék felírásakor mindig csak az utoljára kijelölt csoportból tudunk eltávolítani elemeket!

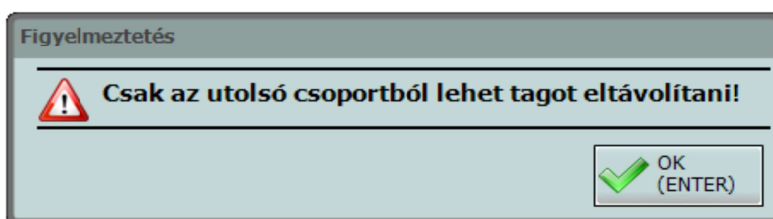

## 3. Ellenjegyzés:

GYSE *rendelet* 10.sz melléklet: legfeljebb 4 hónapon keresztül történő sebellátásra, ha a test bármely részén kialakult hám- és szövethiány várhatóan több mint 6 héten keresztül nem gyógyul. Ha a kötszerekkel való kezelés időtartama a 4 hónapot eléri, a kezelőorvos az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja a kezelést.


A készítményt ha előzetesen ellenjegyzésre kell küldeni, akkor a GYSE – egyéb adatok ablakon az Előzetes ellenjegyzés szükséges opciót be kell pipálni. Ilyenkor ellenjegyzésre vár státuszban kerül be a térbe és az egészségbiztosító ellenőrző főorvosa fogja a térben ezt ellenjegyezni, ezután tudják kiváltani.

The screenshot shows the 'GYSE - egyéb adatok' form. The 'Nyilatkozat rendelkezésre áll' section is expanded. Under 'Előzetes engedély', the 'Előzetes engedélyezés szükséges' checkbox is unchecked. Under 'Ellenjegyzés', the 'Előzetes ellenjegyzés szükséges' checkbox is checked and highlighted with a red box. The form includes fields for 'Eng.szám' and 'Érvényes' dates, as well as sections for 'Méretváltozás miatt új termék', 'Állapotváltozás miatt új termék', 'Egyedi méretvétel', 'Orvosi utasítás GYSE kiadónak', 'Testtáj', 'Felírt mennyiség indoklása', 'Jav. gyári.sz.', 'Hiba jellegének szöveges meghatározása', 'Oldaliság', and 'Dokumentum' fields.


Ha már van engedélyezve van, akkor az engedély számát és érvényesség dátumát kell csak kitölteni.

The screenshot shows the 'GYSE - egyéb adatok' form with the 'Előzetes ellenjegyzés szükséges' checkbox checked and highlighted with a red box. The 'Eng.szám' field is filled with '123456/2020/16' and the 'Érvényes' field is filled with '2021.09.21' and '2022.09.21'. The rest of the form structure is identical to the previous screenshot.

4. ISO 10 kód alapján felírás (pl. parókák): A GYSE rendelet 19. számú mellékletben meghatározott eszközcsoportokba tartozó gyógyászati segédeszközöket az orvos az eszköz megnevezése helyett a ISO10 kódhoz tartozó eszközcsoport megnevezésével is rendelheti.

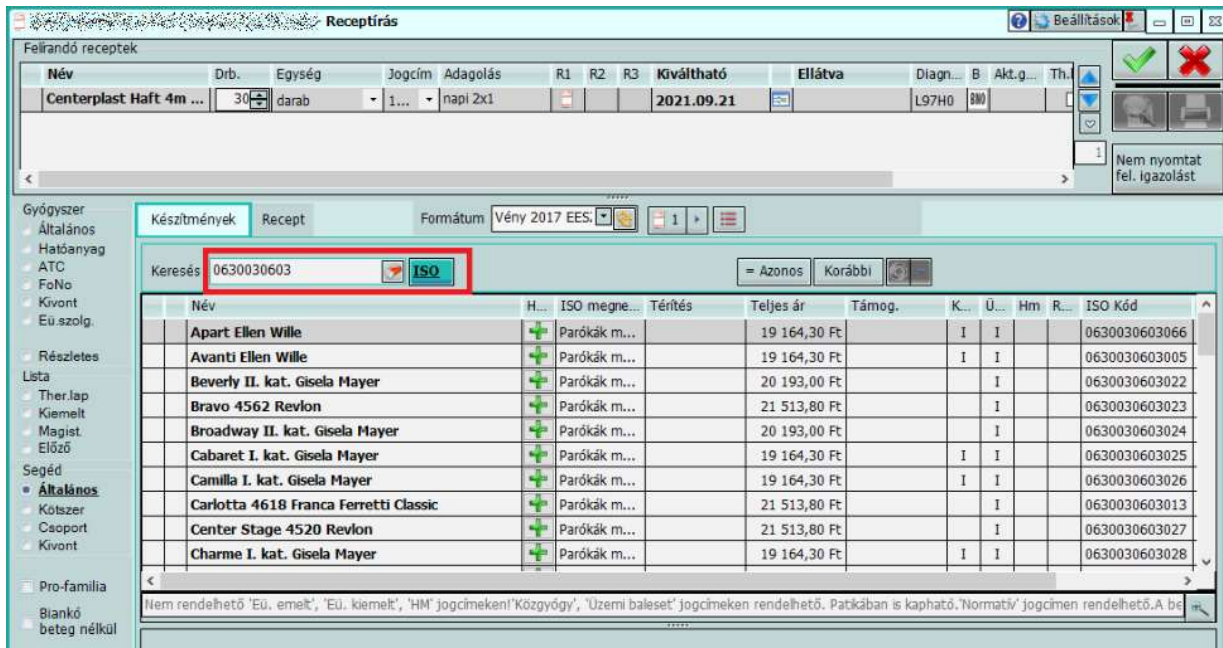



ISO 10 kódra keresve és felírva a készítményt a GYSE felírás típusát át kell állítani 8 GYSE/ISO típusra, ilyenkor nem egy konkrét készítmény lesz felírva, hanem egy ISO csoport és ezen belül majd a kiadó oldal döntheti el, pontosan melyik segédeszközt adja ki.

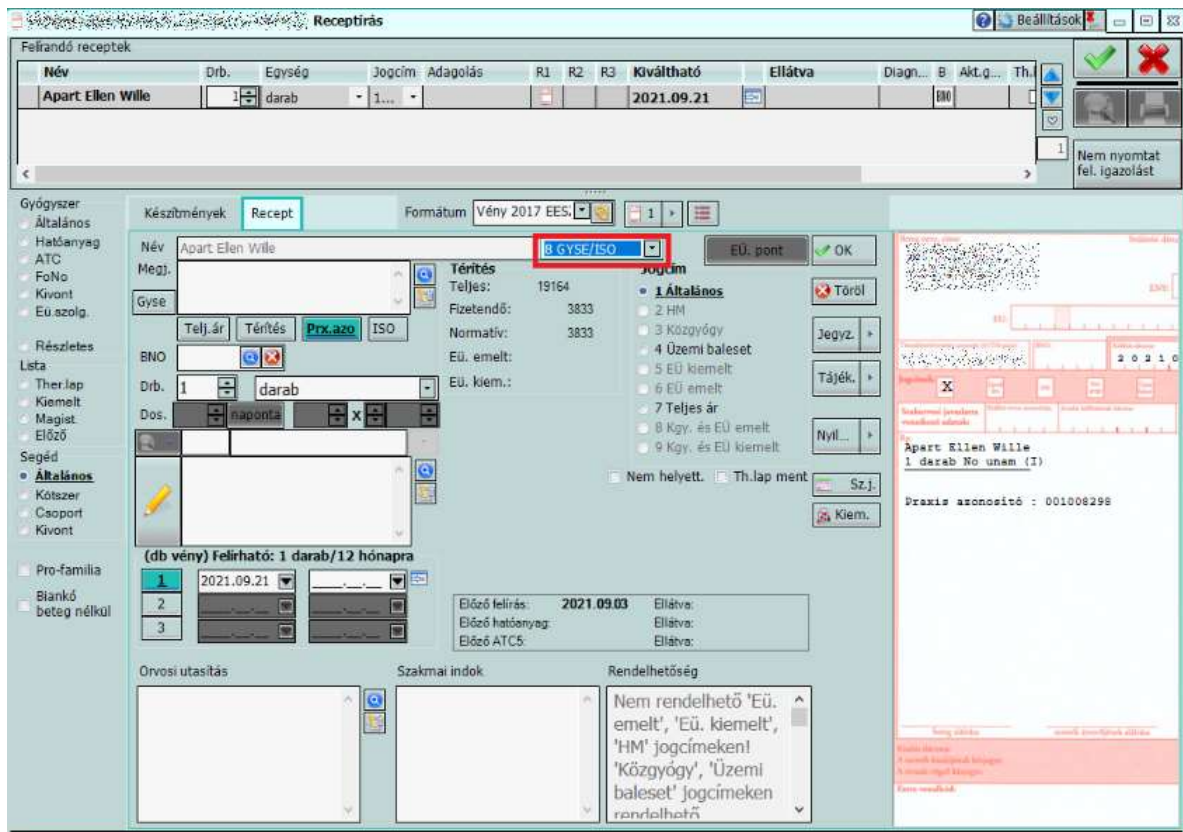




6. **Állapotváltozás / Méretváltozás** : A kihordási idő letelte előtt társadalombiztosítási támogatással akkor lehet ismét azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt igénybe venni, ha a beteg egészségi-, illetve testi állapotában bekövetkezett változás – ide értve az életkorral összefüggő méretváltozást is – ezt szükségessé teszi, vagy ha az eszköz különböző testrészek egy időben történő, azonos kezelését szolgálja. Az állapot- vagy méretváltozás tényét, okát és mértékét rögzíteni kell az elektronikus vényen. Kihordási időn belüli újrafelírás esetén az állapotváltozás vagy a méretváltozás indokát a Gyse ablakon kell feltüntetni.

7. A rendeltetészerű használat során a kihordási időn belül és a kötelező vagy a gyártó által vállalt jótállási idő lejártát követően meghibásodott – a korábban ártámogatással vásárolt – gyógyászati segédeszközök egyúttal társadalombiztosítási támogatással javíthatóak is, ha a kezelőorvos vagy a háziorvos vényen rendeli. Segédeszköz javítás esetén, a GYSE felírás módját 9 GYSE/Javítás-ra kell állítani, illetve a Gyse ablakon a Hiba jellegének szöveges meghatározásába lehet megadni a javítás indoklását, hiba jellegét.

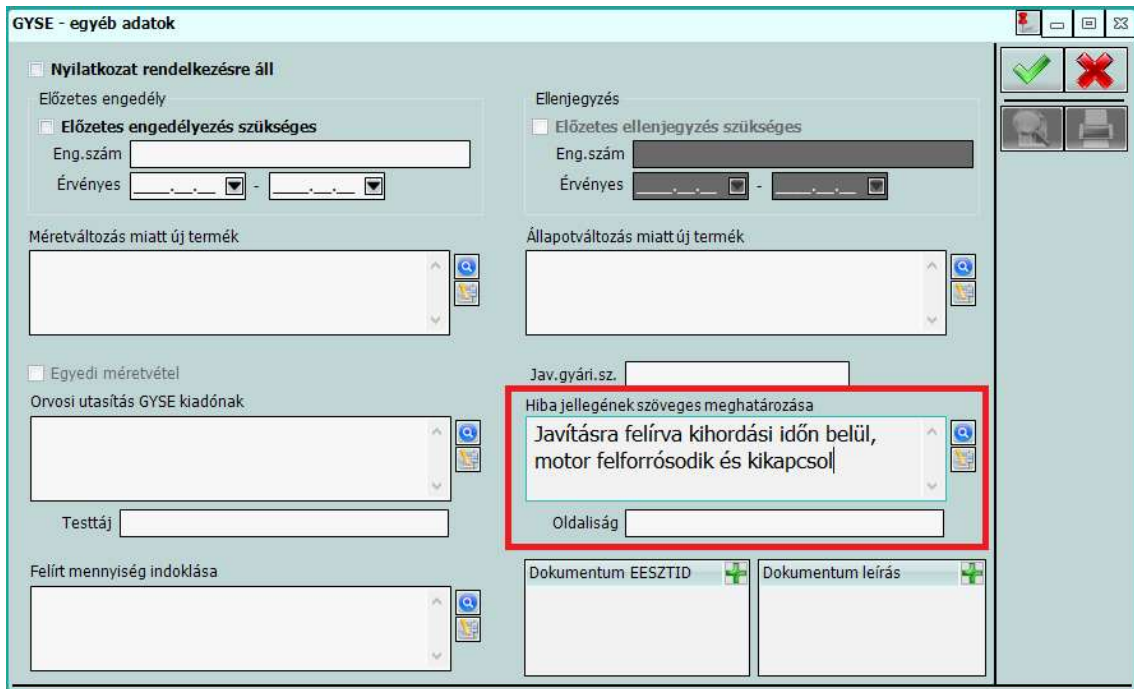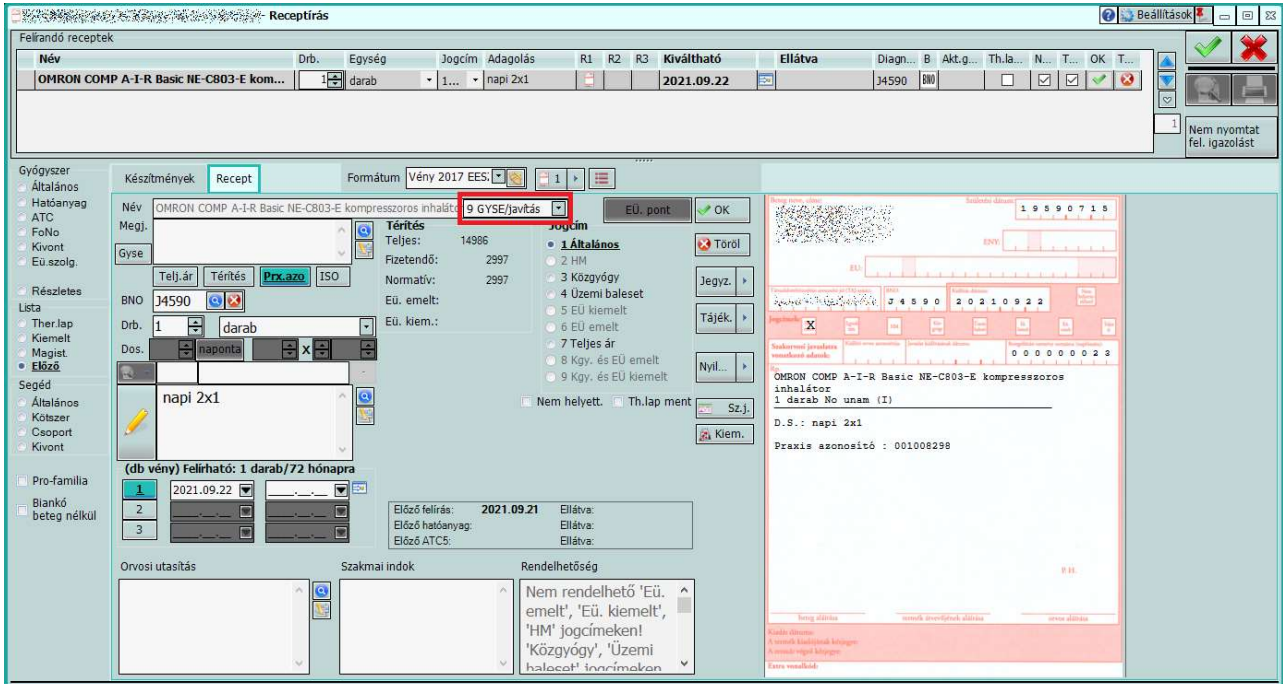




8. Oxigén kölcsönzés : Kölcsönzés esetén a GYSE felírás módját 10 GYSE/Kölcsönzésre kell állítani. Ilyenkor megjelenik egy Kölcsönzés időtartama opció, ahol be tudjuk állítani a kölcsönzés időtartamát.

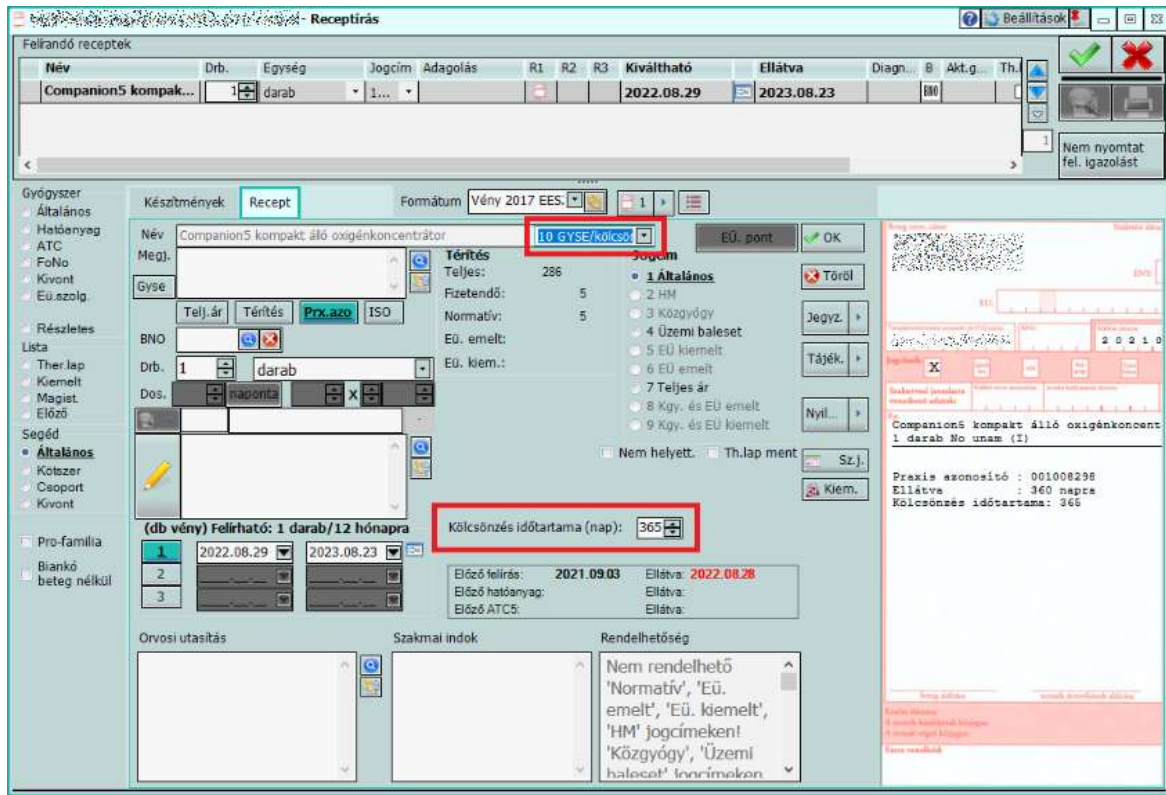

9. EU kártyás felírás:  
Elektronikus GYSE vény társadalombiztosítási támogatással, TAJ-szám mellett, kizárólag Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező páciens számára írható.

A páciens kartonján ki kell tölteni az Azon. Típust 8 Európa kártyára, az Egyéb a. \*-hoz beírni az EU kártya számát.

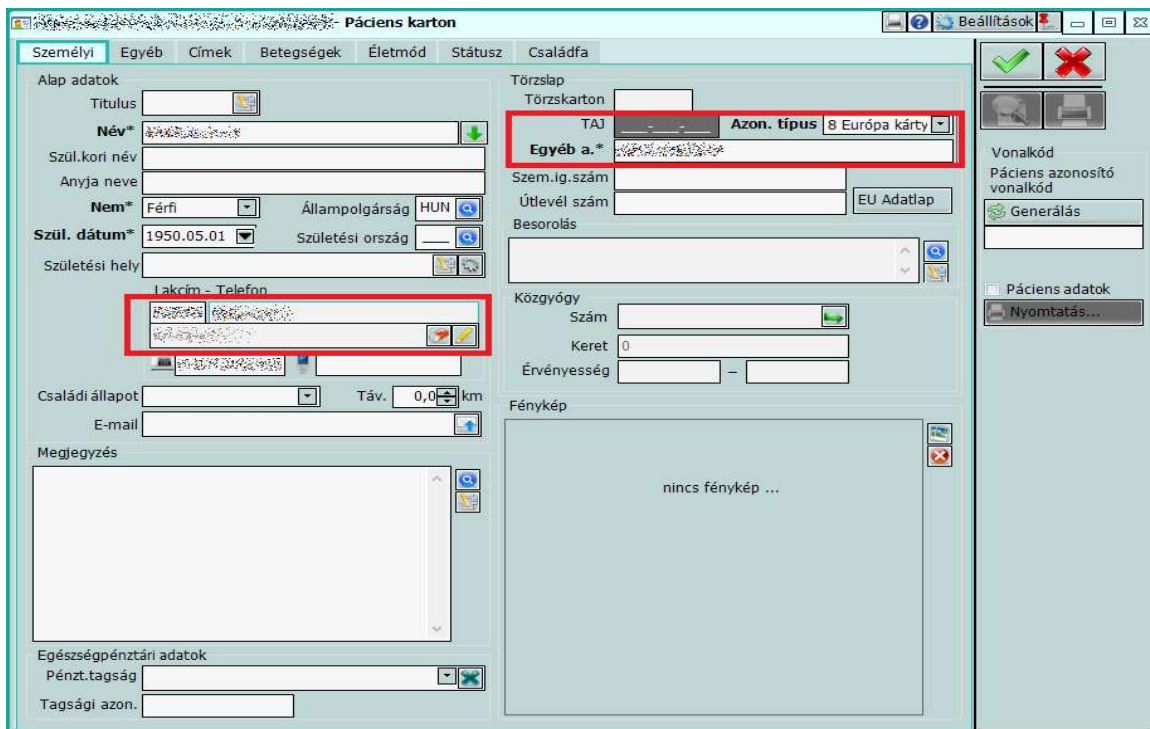

Ha a lakcime külföldi, akkor a Részletes cím adatoknál ki kell tölteni a országot a jobb alsó sarkában, innen tudja majd az EESZT, hogy nem magyarországi címet küldünk be.

**Részletes cím adatok**

Közterület neve, jellege  
Bem ulica


Házzám Épület Lépcsőház Szint Ajtó Kerület  
3 II.

(Hrsz esetén a közterület neve + a házzám mező használható)


POL

**Kivételek / Ellenőrzések:**


- Műfogsorok : 06 30 36 , 06 30 37 , optikai segédeszközök : 21 03 – ezek felírása tiltott eGYSE-ként, csak vényen lehet.
- Felírás előtt vizsgálja, hogy az adott páciens neme szerint lehet-e neki felírni a készítményt, ha nem akkor nem engedi.

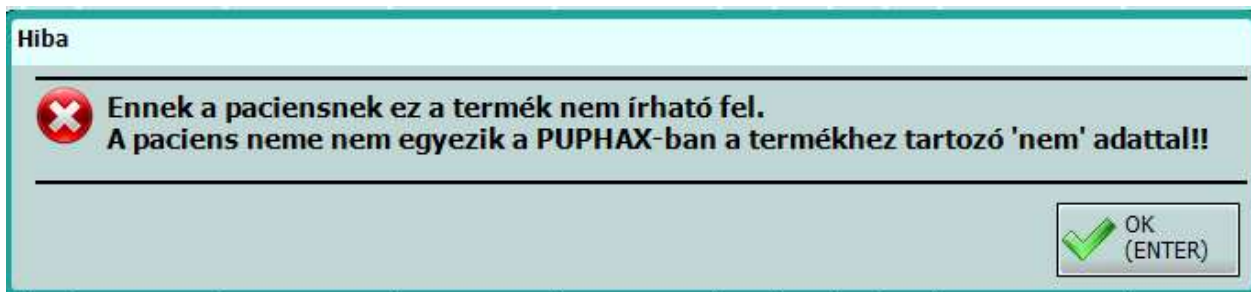


- Recept felírásakor ellenőrzi az életkor szerinti felírhatóságot, nem engedi felírni, ha a páciens életkora az adott jogcímnél esetleg nem engedi.

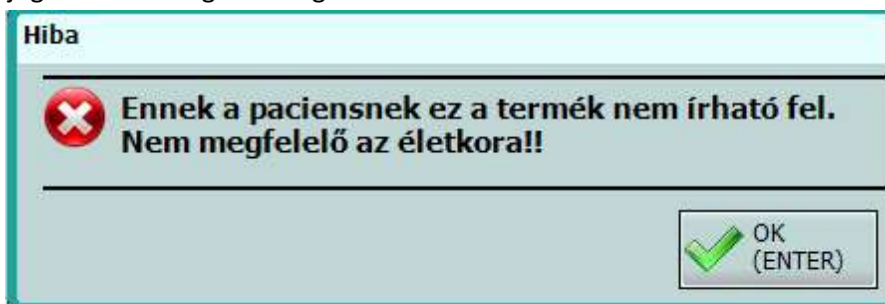

- Recept felírásakor ellenőrzi az oldaliság, testtáj kitöltöttségét bizonyos készítményeknél.

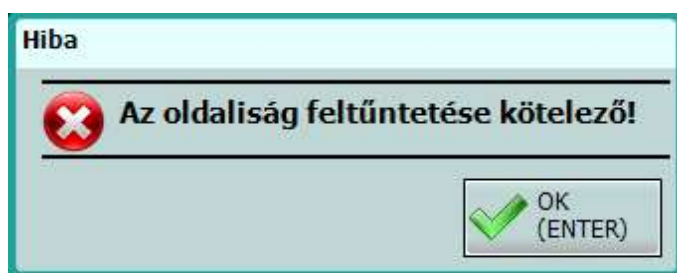

- Recept felírásakor ellenőrzi az adagolás kitöltöttségét.

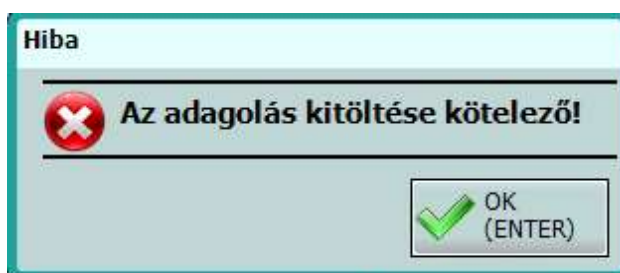

- Előzetes engedélyezést csak papír vényen lehet kiállítani.
- Az ellenjegyzés részt a törzs alapján állítja be, 3 lehetőség lehet, teljesen tiltva van, fixen be van pipálva, illetve az orvos által eldöntendő, ilyenkor lehet pipálni ha kell.

Ellenjegyzés

Előzetes ellenjegyzés szükséges

Eng.szám

Érvényes  -

Ellenjegyzés

Előzetes ellenjegyzés szükséges

Eng.szám

Érvényes  -

Ellenjegyzés

Előzetes ellenjegyzés szükséges

Eng.szám

Érvényes  -

**Lekérdezés:**

Az EESZT panelra került egy új kategória a GYSE. Itt tudjuk lekérdezni az adott páciensnek felírt eGYSE készítményeket. Fontos, hogy csak az általunk felírt eGYSE készítményeket adja vissza a tér, a más orvos által felírtat nem.

EESZT panel

Felhasználó: 000517 - SAML jegy érv.: 2021.09.23. 14:40 [Belépve]

Szünet Csoportos FIG PRO beküldés

Lekérdezés Beállítások Segédletek

Lekérdezés paraméterek

Időszak 2021.08.22 - 2021.09.22 Lekérdezés

Modul

KAT PRO EHR BEU EPU ID  Aktív (nem kiváltott)  Törölt is

REC DOC **GYSE**

EESZT DEV Béla - 114-411-440 - 1959.07.15

Keresés

	Felírás	Név	Érvényes
	21.09.22	Victofon Journey 80 TTT: 310205435	2021.09.22 - 2021.12.21
	21.09.22	Victofon Journey 80 TTT: 310205435	2021.09.22 - 2021.12.21
	21.09.21	Tena Men Level 2 (450 ml) TTT: 31004...	2021.09.21 - 2021.12.20
	21.09.17	Centerplast Haft 4m x 10cm TTT: 4101...	2021.09.17 - 2021.12.16
	21.09.17	Kliniderm Foam 10 x 18 cm TTT: 41019...	2021.09.17 - 2021.12.16
	21.09.17	Medicomp Extra 10 x 10 cm TTT: 4100...	2021.09.17 - 2021.12.16
	21.09.16	KL-03 TTT: 310152860	2021.09.16 - 2021.12.15

RAPID MLABOR Lista nézet

**Victofon Journey 80 TTT: 310205435**  
STÁTUSZ: Nyitott

Érvényes: 2021.09.22 - 2021.12.21

eReceptID: 302100000681162392

[Részletes adatok](#)

Üzenetek

14:54 - OK: GYSE bejegyzések lekérdezése


14:42 - OK: GYSE beküldés - Victofon Journey 80

14:42 - OK: GYSE beküldés - Victofon Journey 80


Naptár EESZT panel Email érkeztetés

### Törlés / FIG küldés:

A csoportos felírási igazolás küldése a megszokott módon megy mint eddig, az EESZT panel tetején található Csoportos FIG gombbal. Ha gyógyszert és segédeszközt is írtunk fel, akkor két fülön Felírási igazolás lesz, először a gyógyszereké, majd ha ezt ebzártuk akkor megnyílik a segédeszközök FIG-je.

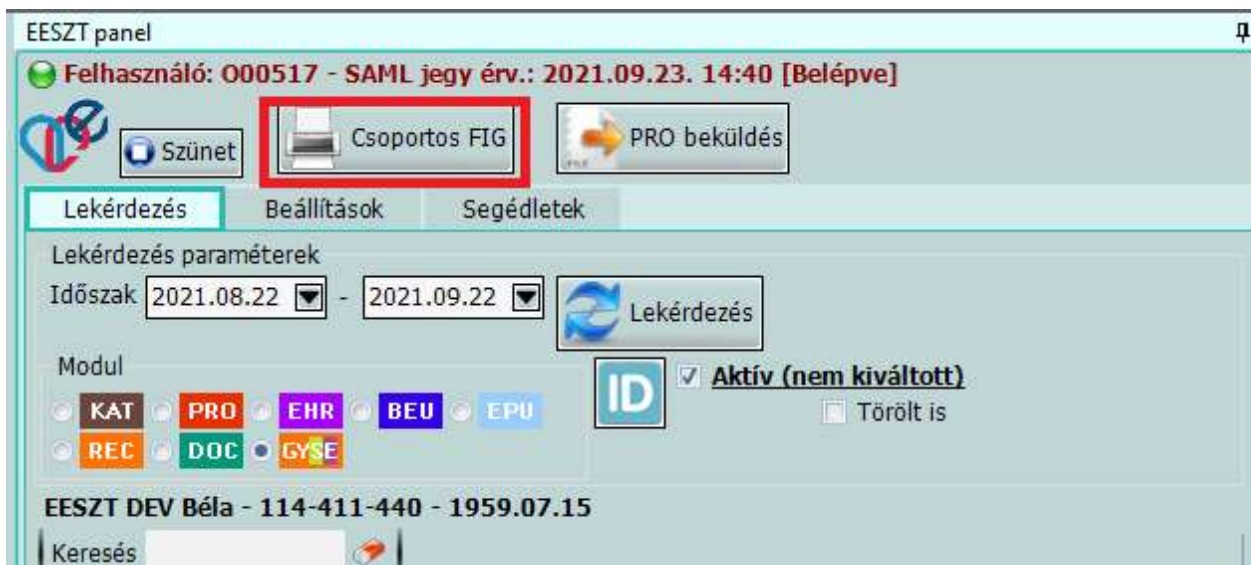

Az eGYSE törlés szintén a megszokott módon megy mint az eddigi receptek törlése.

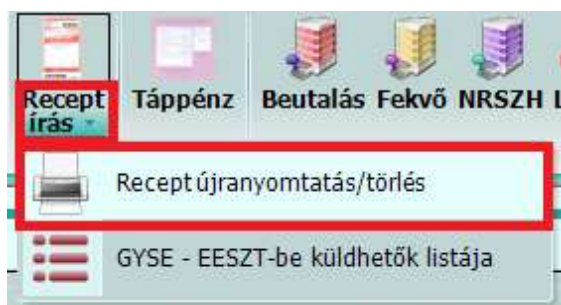

Recept újrayomtatás/törlés

Választható dátumok: 2021. szeptember 22. 14:04

T	Je	N	Név	Egység	Darab	Jogcím	Adagolás	Kiváltható	Ellátva	Diag...	TTT	EESZT Id
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		EL-GO, elektromos	darab	1	Általános	az orvos kezei...				310045479	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Sunbrow 4 Hard Coat ...	darab	1	Általános		2021.09.22		L8130	310168811	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Victofon Journey 80	darab	1	Általános	teszt	2021.09.22		L8130	310205435	30210000681162392
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Victofon Journey 80	darab	1	EÜ emelt	teszt	2021.09.22		L8130	310205435	30210000681281785

Kiválasztottak törlése